

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ


Термопреобразователи сопротивления ТСМг и ТСПр

Назначение средства измерений

Термопреобразователи сопротивления ТСМг и ТСПр (в дальнейшем термопреобразователи) предназначены для измерения температуры жидких, газообразных, сыпучих сред и твердых тел, химически неагрессивных и не разрушающих материал защитного корпуса.

Описание средства измерений

Принцип действия термопреобразователей основан на известной зависимости электрического сопротивления платины (меди) от температуры. Термопреобразователь представляет собой чувствительный элемент из платины (для ТСПр) или меди (для ТСМг), помещенный в защитную арматуру. Чувствительный элемент представляет собой малогабаритную катушку сопротивления специальной намотки из платиновой (медной) проволоки или тонкую плёнку из платины (меди) на керамической подложке. Чувствительный элемент, соединяется при помощи выводов с герметичной клеммной головкой или же выводные проводники выведены через уплотнение в наружной части защитной арматуры. Термопреобразователи сопротивления ТСМг и ТСПр имеют по 15 конструктивных исполнений в зависимости от номинальной статической характеристики, конструктивного оформления, диапазона измеряемых температур, класса допуска и схемы внутренних соединений. Программное обеспечение отсутствует.

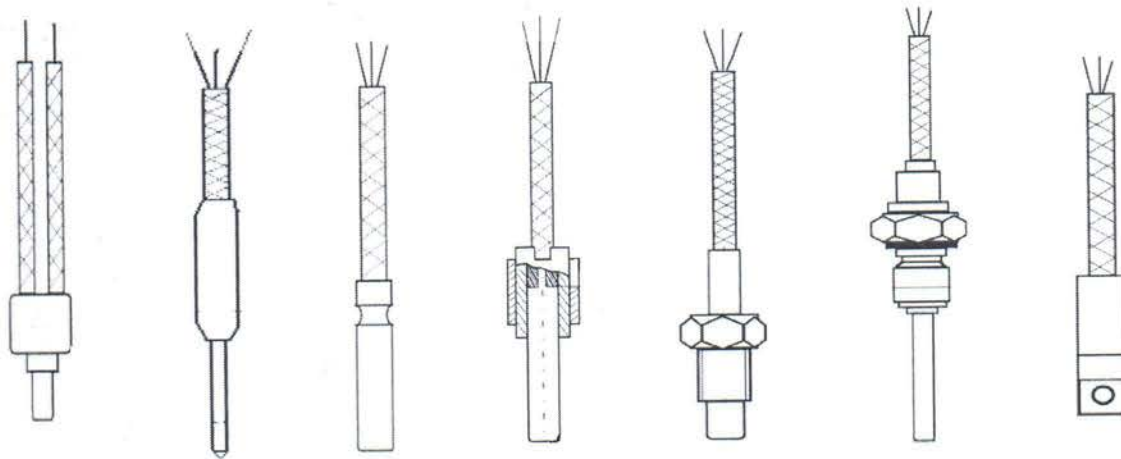

ТСМг-K0
ТСПг-K0

ТСМг-K1И
ТСПг-K1И


ТСМг-K2
ТСПг-K2

ТСМг-K2-1
ТСПг-K2-1

ТСМг-K3
ТСПг-K3

ТСМг-K4
ТСПг-K4

ТСМг-K5
ТСПг-K5

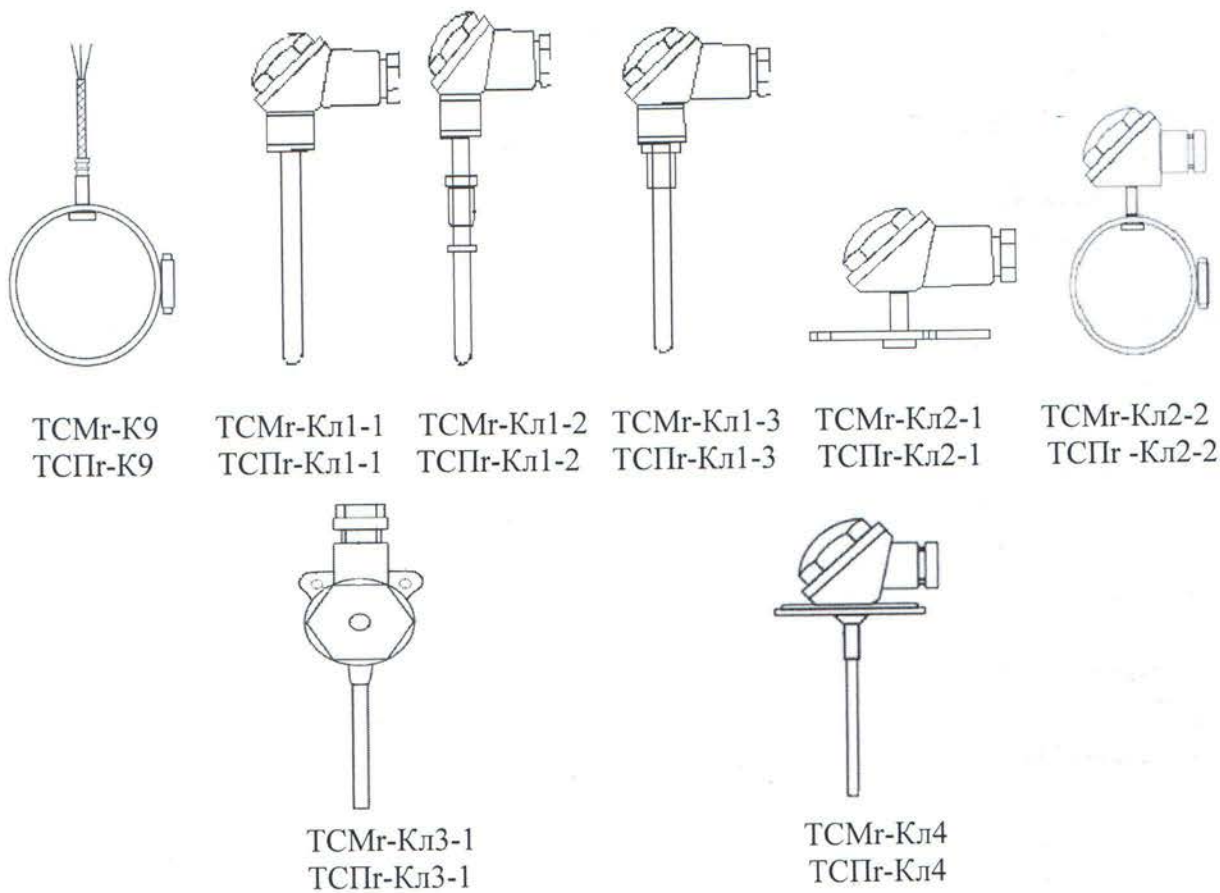

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики термопреобразователей сопротивления приведены в таблице 1.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульные листы паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - термопреобразователь сопротивления | - 1 шт |
| - руководство по эксплуатации | - 1 экз. на партию по требованию заказчика |
| - паспорт | - 1 экз. |

Поверка

осуществляется по ГОСТ 8.461-2009 "ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки". При поверке применяются: термометры сопротивления платиновые эталонные ЭТС 100 3-го разряда; термостат жидкостный мод.7312, воспроизводимая температура 0°C, нестабильность поддержания температуры $\pm 0,003^\circ\text{C}$; термостат регулируемый ТР-1М, диапазон температур от 40 до 200 °C, нестабильность поддержания температуры $\pm 0,05^\circ\text{C}$; прецизионный цифровой мост постоянного тока 1590, погрешность $\pm 0,5 \text{ мК}$.

ТСП

Наименование параметров и характеристик	конструктивные исполнения								
	К0	К1И	К2	К2-1	К3	К4	К5	К9	
Диапазон измеряемых температур, °С	от -50 до 150	от -50 до 180	от -50 до 180	от -50 до 180	от -50 до 180	от -50 до 180	от -50 до 180	от -50 до 180	от -50 до 180
Номинальная статическая характеристика	Rt100, Pt1000	Rt100, Pt1000, 50П, 100П	Rt100, Pt1000, 50П, 100П	Rt100, Pt1000, 50П, 100П	Rt100, Pt1000, 50П, 100П	Rt100, Pt1000, 50П, 100П	Rt100, Pt1000, 50П, 100П	Rt100, Pt1000, 50П, 100П	Rt100, Pt1000, 50П, 100П
Номинальное сопротивление, Ом	100, 1000	50, 100, 1000	50, 100, 1000	50, 100, 1000	100, 1000	50, 100, 1000	100, 1000	100, 1000	100, 1000
Класс допуска	В	В	А, В	А, В	В	А, В	В	В	В
Допуск, отклонение от НСХ, °С	класс А±(0,15 + 0,002 t), класс В±(0,3 + 0,005 t , где t-измеряемая температура								
Время термической реакции, с, не более	4	3;7	3;7;9;15	7;9	12	10;12;15;20	7;9	15	15
Защита от воды и пыли	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Схема соединений выводов	2-х, 3-х проводная	3-х проводная	2-х, 3-х проводная	2-х, 3-х проводная	2-х, 3-х проводная	2-х, 3-х проводная	2-х, 3-х проводная	2-х, 3-х проводная	2-х, 3-х проводная
Диаметр монтажной части, мм	3	2;4	2; 4; 5; 6	4; 5;	4	4;5;6;8	4x4 5x5	Ø хомута 20, 40, 60, 80, 120	-
Длина монтажной части защитной арматуры, мм	10	100;120	20;30;60; 80; 100	60; 80; 100	13	60; 80; 100; 120;160;200; 250; 300	60	-	-
Материал защитной арматуры	сталь 12Х18Н10Т								
Масса, кг	0,02-0,2	0,02-0,2	0,10-0,15	0,10-0,15	0,10-0,15	0,03-0,30	0,10-0,15	0,10-0,15	0,10-0,15
Средний срок службы, лет	6								
Наработка на отказ, ч	40000								
Условия эксплуатации: -диапазон температур окружающего воздуха, °С -относительная влажность, %	от - 50 до 100 до 100 при 40 °С								

ТСП

Наименование параметров и характеристик	конструктивные исполнения							
	Кл1-1 от -50 до 180	Кл1-2 от -50 до 180	Кл1-3 от -50 до 180	Кл2-1 от -50 до 180	Кл2-2 от -50 до 180	Кл3-1 от -50 до 100	Кл4 от -50 до 100	
Диапазон измеряемых температур, °С	от -50 до 180	от -50 до 180	от -50 до 180	от -50 до 180	от -50 до 180	от -50 до 100	от -50 до 100	
Номинальная статическая характеристика	Rt100, Rt1000, 50П, 100П	Rt100, Rt1000, 50П, 100П	Rt100, Rt1000, 50П, 100П	Rt100, Rt1000	Rt100, Rt1000	Rt100, Rt1000, 50П, 100П	Rt100, Rt1000, 50П, 100П	
Номинальное сопротивление, Ом	50, 100, 1000	50, 100, 1000	50, 100, 1000	100, 1000	100, 1000	50, 100, 1000	50, 100, 1000	
Класс допуска	A, B	A, B	A, B	B	B	B	A, B	
Допуск, отклонение от НСХ, °С	класс A±(0,15 + 0,002 t), класс B±(0,3 + 0,005 t), где t-измеряемая температура							
Время термической реакции, с, не более	9;15;20;30	9;15;20;30	9;15;20;30	15	15	15	3;7	
Защита от воды и пыли	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	
Схема соединений выводов	3-х проводная	3-х проводная	3-х проводная	3-х проводная	3-х проводная	2-х проводная	3-х проводная	
Диаметр монтажной части, мм		5;6;8;10		65	Ø хомута 20; 40;60;80;120	6	2;4	
Длина монтажной части защитной арматуры, мм		80; 100; 120; 160; 200; 300; 400; 500; 630; 800; 1000		-	-	80	100;200	
Материал защитной арматуры	Сталь 12Х18Н10Т							
Масса, кг	0,02-1,5	0,03-1,5	0,03-1,52	0,05-0,2	0,03-0,3	0,03-0,1	0,03-0,3	
Средний срок службы, лет	6							
Наработка на отказ, ч	40000							
Условия эксплуатации: -диапазон температур окружающего воздуха, °С -относительная влажность, %	от - 50 до 50 до 95 при 35 °С						от -5 до 50 80 при 35 °С	от - 50 до 50 до 95 при 35 °С

Наименование параметров и характеристик	ТСМг								
	конструктивные исполнения								
	К0	К1И	К2	К2-1	К3	К4	К5	К9	
Диапазон измеряемых температур, °С	от -50 до 150	от -50 до 180	от -50 до 180	от -50 до 180	от -50 до 180	от -50 до 180	от -50 до 180	от -50 до 180	от -50 до 180
Номинальная статическая характеристика	50М	50М,100М	50М,100М	50М,100М	50М,100М	50М	50М,100М	50М	50М
Номинальное сопротивление, Ом	50	50,100	50,100	50,100	50,100	50	50,100	50	50
Класс допуска	С	В, С	В, С	В	В, С	В, С	В, С	В, С	В, С
Допуск, отклонение от НСХ, °С	класс В±(0,3 + 0,005 t), класс С±(0,6 + 0,01 t), где t-измеряемая температура								
Время термической реакции, с, не более	4	3;7	3;7;9;15	7;9	12	10;12;15;20	7;9	15	
Защита от воды и пыли	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Схема соединений выводов	2-х, 3-х проводная	3-х проводная	2-х,3-х проводная	2-х,3-х проводная	2-х,3-х проводная	2-х,3-х проводная	2-х,3-х проводная	2-х,3-х проводная	2-х,3-х проводная
Диаметр монтажной части, мм	3	2;4	2; 4; 5; 6	4; 5;	4	4;5;6;8	4х4 5х5	Ø хомута 20, 40,60,80,120	
Длина монтажной части защитной арматуры, мм	10	100;120	20;30;60; 80; 100	20;30;60; 80; 100	13	60; 80; 100; 120;160;200; 250; 300	60	-	
Материал защитной арматуры	сталь 12Х18Н10Т								
Масса, кг	0,1-0,2	0,02-0,2	0,10-0,15	0,10-0,15	0,10-0,15	0,03-0,30	0,10-0,15	0,10-0,15	0,10-0,15
Средний срок службы, лет	6								
Наработка на отказ, ч	40000								
Условия эксплуатации: -диапазон температур окружающего воздуха, °С -относительная влажность, %	от - 50 до 100 до 100 при 40 °С								

ТСМг

Наименование параметров и характеристик	конструктивные исполнения							
	Кл1-1	Кл1-2	Кл1-3	Кл2-1	Кл2-2	Кл3-1	Кл4	
Диапазон измеряемых температур, °С	от -50 до 180	от -50 до 180	от -50 до 180	от -50 до 180	от -50 до 180	от -50 до 100	от -50 до 100	
Номинальная статическая характеристика	50М; 100М	50М; 100М	50М; 100М	50М	50М	50М; 100М	50М; 100М	
Номинальное сопротивление, Ом	50;100	50;100	50;100	50	50	50;100	50;100	
Класс допуска	В	В	В	С	С	В	В, С	
Допуск, отклонение от НСХ, °С	класс В±(0,3 + 0,0051 t), класс С±(0,6 + 0,011 t), где t-измеряемая температура							
Время термической реакции, с, не более	9;15;20;30	9;15;20;30	9;15;20;30	15	15	15	3;7	
Защита от воды и пыли	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	
Схема соединений выводов	3-х проводная	3-х проводная	3-х проводная	3-х проводная	3-х проводная	2-х проводная	3-х проводная	
Диаметр монтажной части, мм	5;6;8;10			65	Ø хомута 20; 40;60;80;120	6	2;4	
Длина монтажной части защитной арматуры, мм	80; 100; 120; 160; 200; 300; 400; 500; 630; 800; 1000			-	-	80	100;200	
Материал защитной арматуры	Сталь 12Х18Н10Т							
Масса, кг	0,02-1,5	0,03-1,5	0,03-1,52	0,05-0,2	0,03-0,3	0,03-0,1	0,03-0,3	
Средний срок службы, лет	6							
Наработка на отказ, ч	40000							
Условия эксплуатации: -диапазон температур окружающего воздуха, °С -относительная влажность, %	от - 50 до 50 до 95 при 35 °С						от - 5 до 50 80 при 35 °С	от - 50 до 50 до 95 при 35 °С

Сведения о методиках (методах) измерений

Термопреобразователи сопротивления используются в качестве первичного преобразователя в комплекте со вторичным прибором, методика прямого измерения изложена в эксплуатационной документации на вторичный прибор.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к термопреобразователям сопротивления ТСМг и ТСПр

1. ГОСТ 6651-2009 " ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний ".
2. ГОСТ 8.558-2009 " ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры".
3. ТУ 4211-035-57200730-2011 "Термопреобразователи сопротивления ТСМг и ТСПр".

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель

ООО "НПК "РЭЛСИБ"

Юридический адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60

Почтовый адрес: 630110, г. Новосибирск, а/я 167, тел. (383) 236-13-84, 226-57-91,

факс (383) 203-39-63, e-mail: ofis@relsib.com; Http://www.relsib.com

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМ им. Д. И. Менделеева", 190005, г. Санкт- Петербург,

Московский пр.19, тел. (812) 251-76-01, факс (812) 713-01-14, e-mail: info@vniim.ru.

Регистрационный номер № 30001-10.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



Ф. В. Булыгин

«04» 10. 2012 г.

ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

7 (семь) л ЛИСТОВ (А)

